



委托单位

江西特斯汀环境检测有限公司

检测项目

南昌云锦纸浆厂及电厂在线比对监测例行检测项目

样品类型

有组织废气

江西特斯汀环境检测有限公司

Jiangxi Teshiding Test Co., Ltd

第 18 页

第 18 页

本公司对检测结果负责。 (盖章)

第 18 页

检测公司电话: 99927003

检测公司地址: 99927003

检测公司网址: 99927003

检测公司邮箱: 99927003

中


以

14000

签发人职位:


授权签字人

(检验检测专用章)

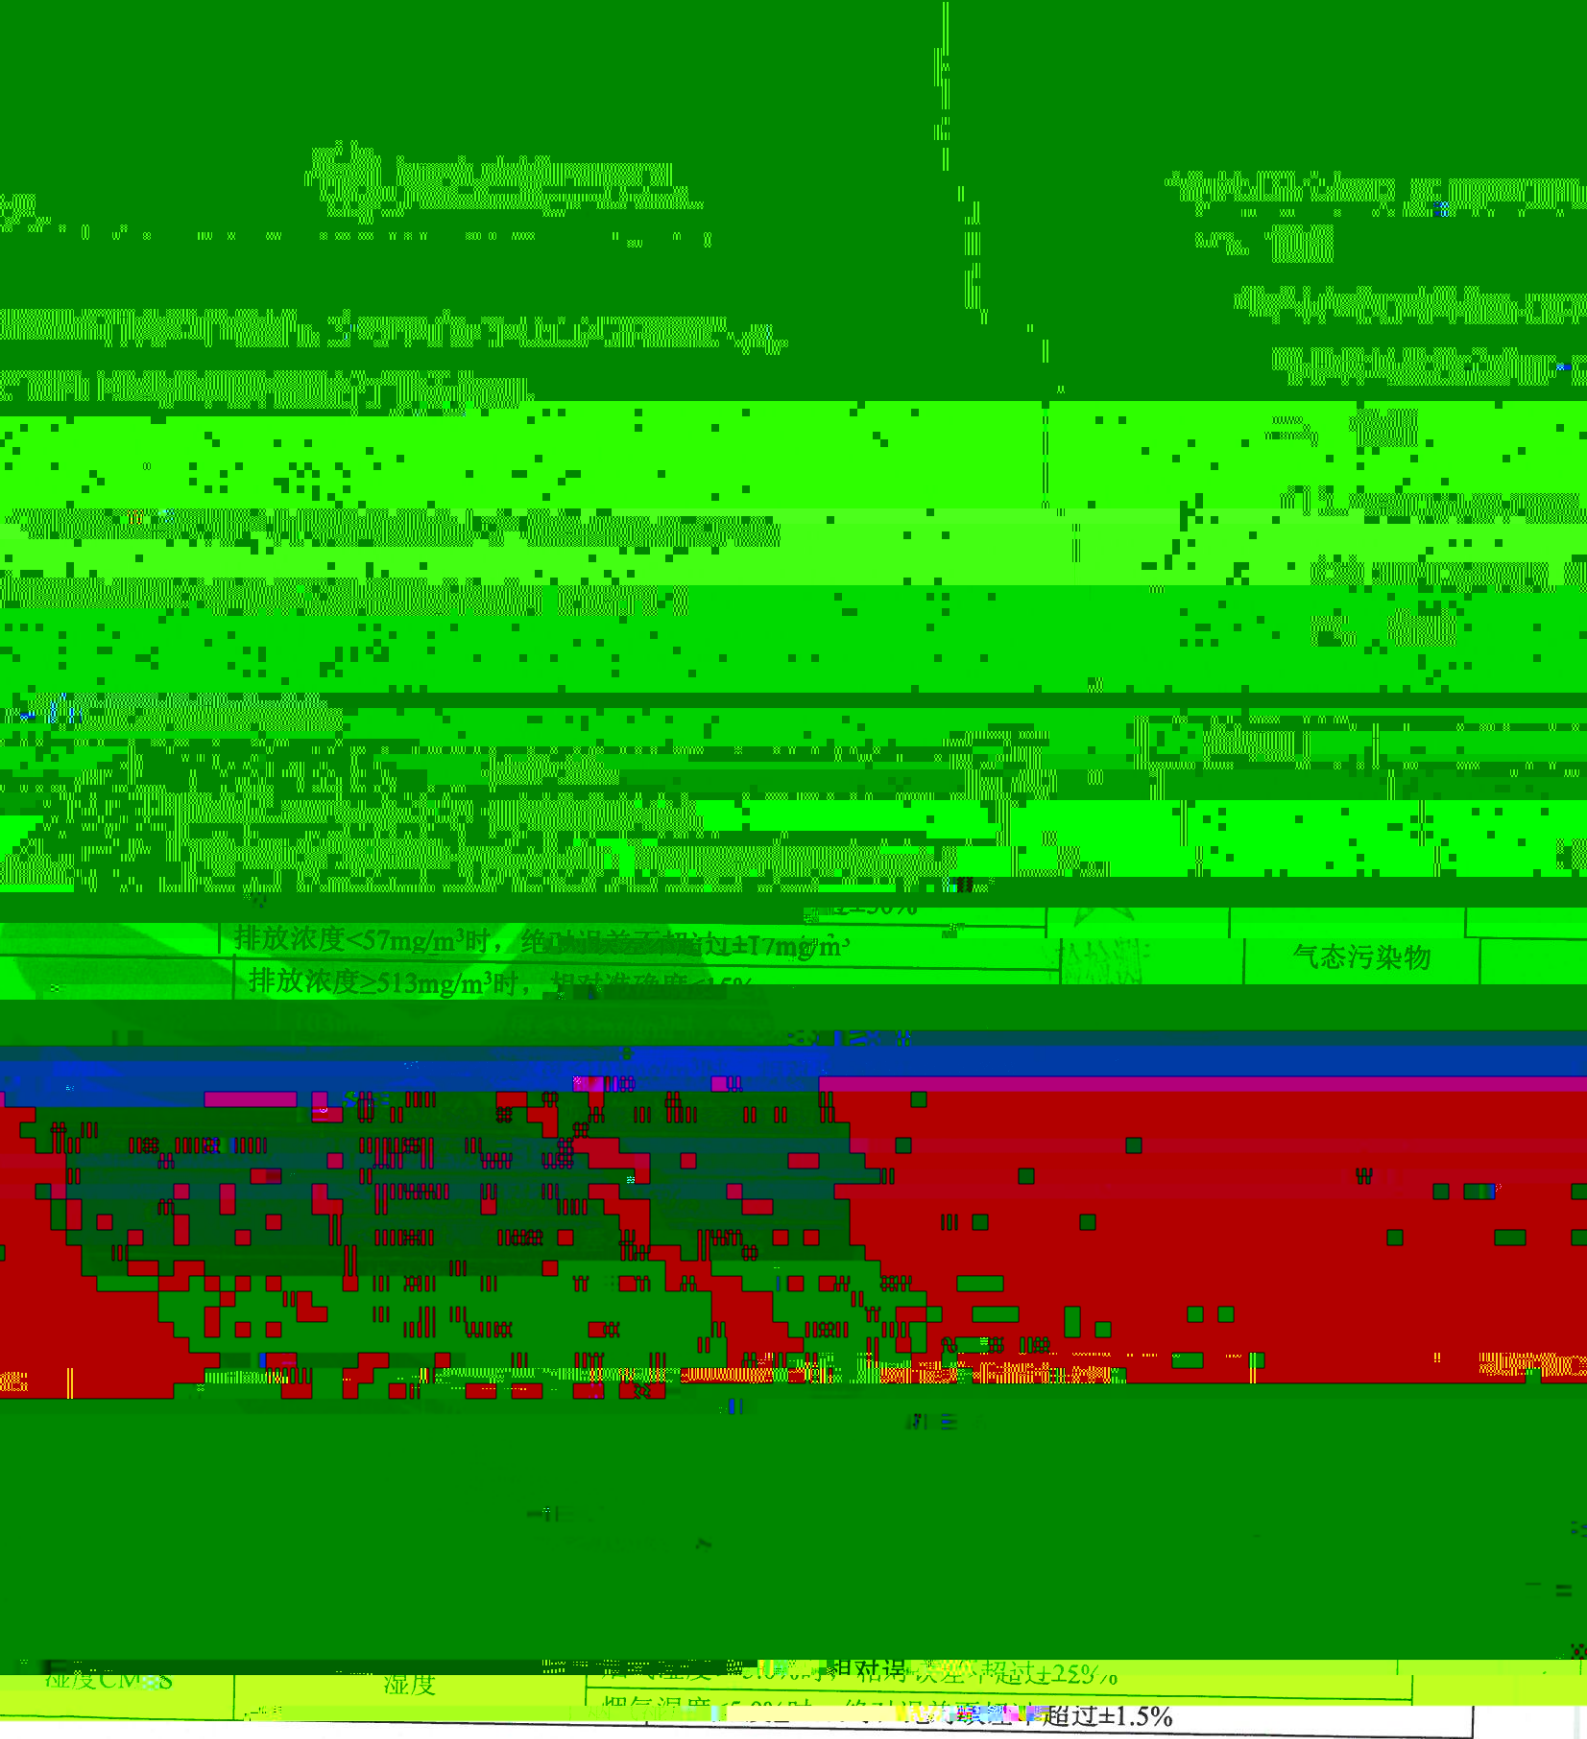

CEMS 系统		FM-5	紫外差分吸收光谱		抚州泽天	
颗粒物分析仪		DMS-100	后散射式		抚州泽天	
二氧化硫分析仪		FM-5	紫外差分吸收光谱		抚州泽天	
氮氧化物分析仪		FM-5	紫外差分吸收光谱		抚州泽天	
烟气流速		PT-500	差压法		抚州泽天	
烟气温度		TE-500	铂电阻		抚州泽天	
项目	CEMS 数据均值	参比方法值	单位	比对监测结果	限值	结果评定
氯化氢	24.2	20.9	mg/m ³	0.31	绝对误差不超过±1/mg/m ³	
氮氧化物	168.028	146.3	mg/m ³	22	绝对误差不得超过±41mg/m ³	达标
二氧化硫	10.951	10.9	%	0.47	绝对误差不超过±10% ±1±3℃	达标
含氧量	21.28	21.55	%	-0.33	相对准确度<15% 相对误差不超过±25%	达标
氯化氢	23.763	4.7	mg/m ³	19		
一氧化碳	0.087	0.3	%	-0.21		

固定污染源废气 GC-EMIS 分析

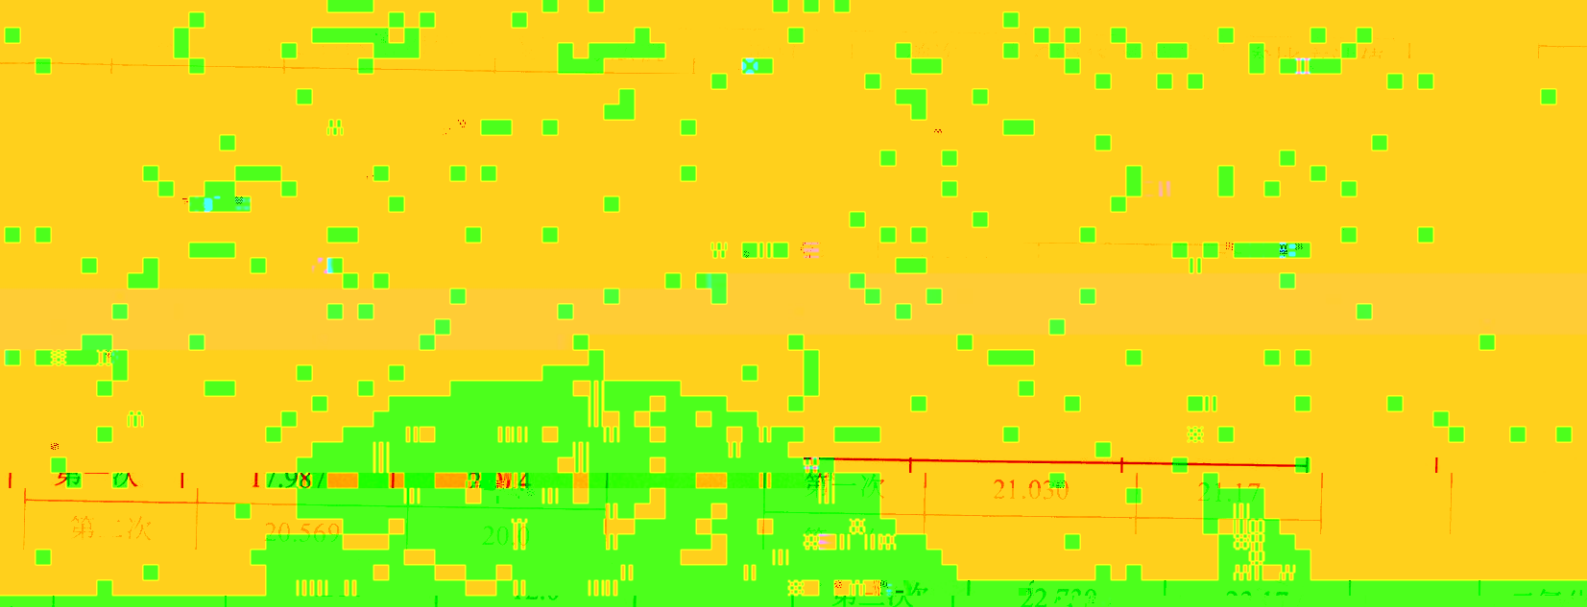


第一次	17.987	20.714	第一次	21.030	21.17
第二次	20.569	20.714	第二次	22.533	22.65

第一次	140.586	141.3	第一次	142.880	143.2
第二次	219.445	146.0	第二次		



第三次	15.247	7.0	第三次	0.005	0.0
第四次	31.914	3.2	第四次	0.021	0.4
第五次	10.145	3.4	第五次	0.108	1.0
第六次	17.917	3.4	第六次	0.092	0.0
平均值	23.763	4.7	平均值	0.087	0.3

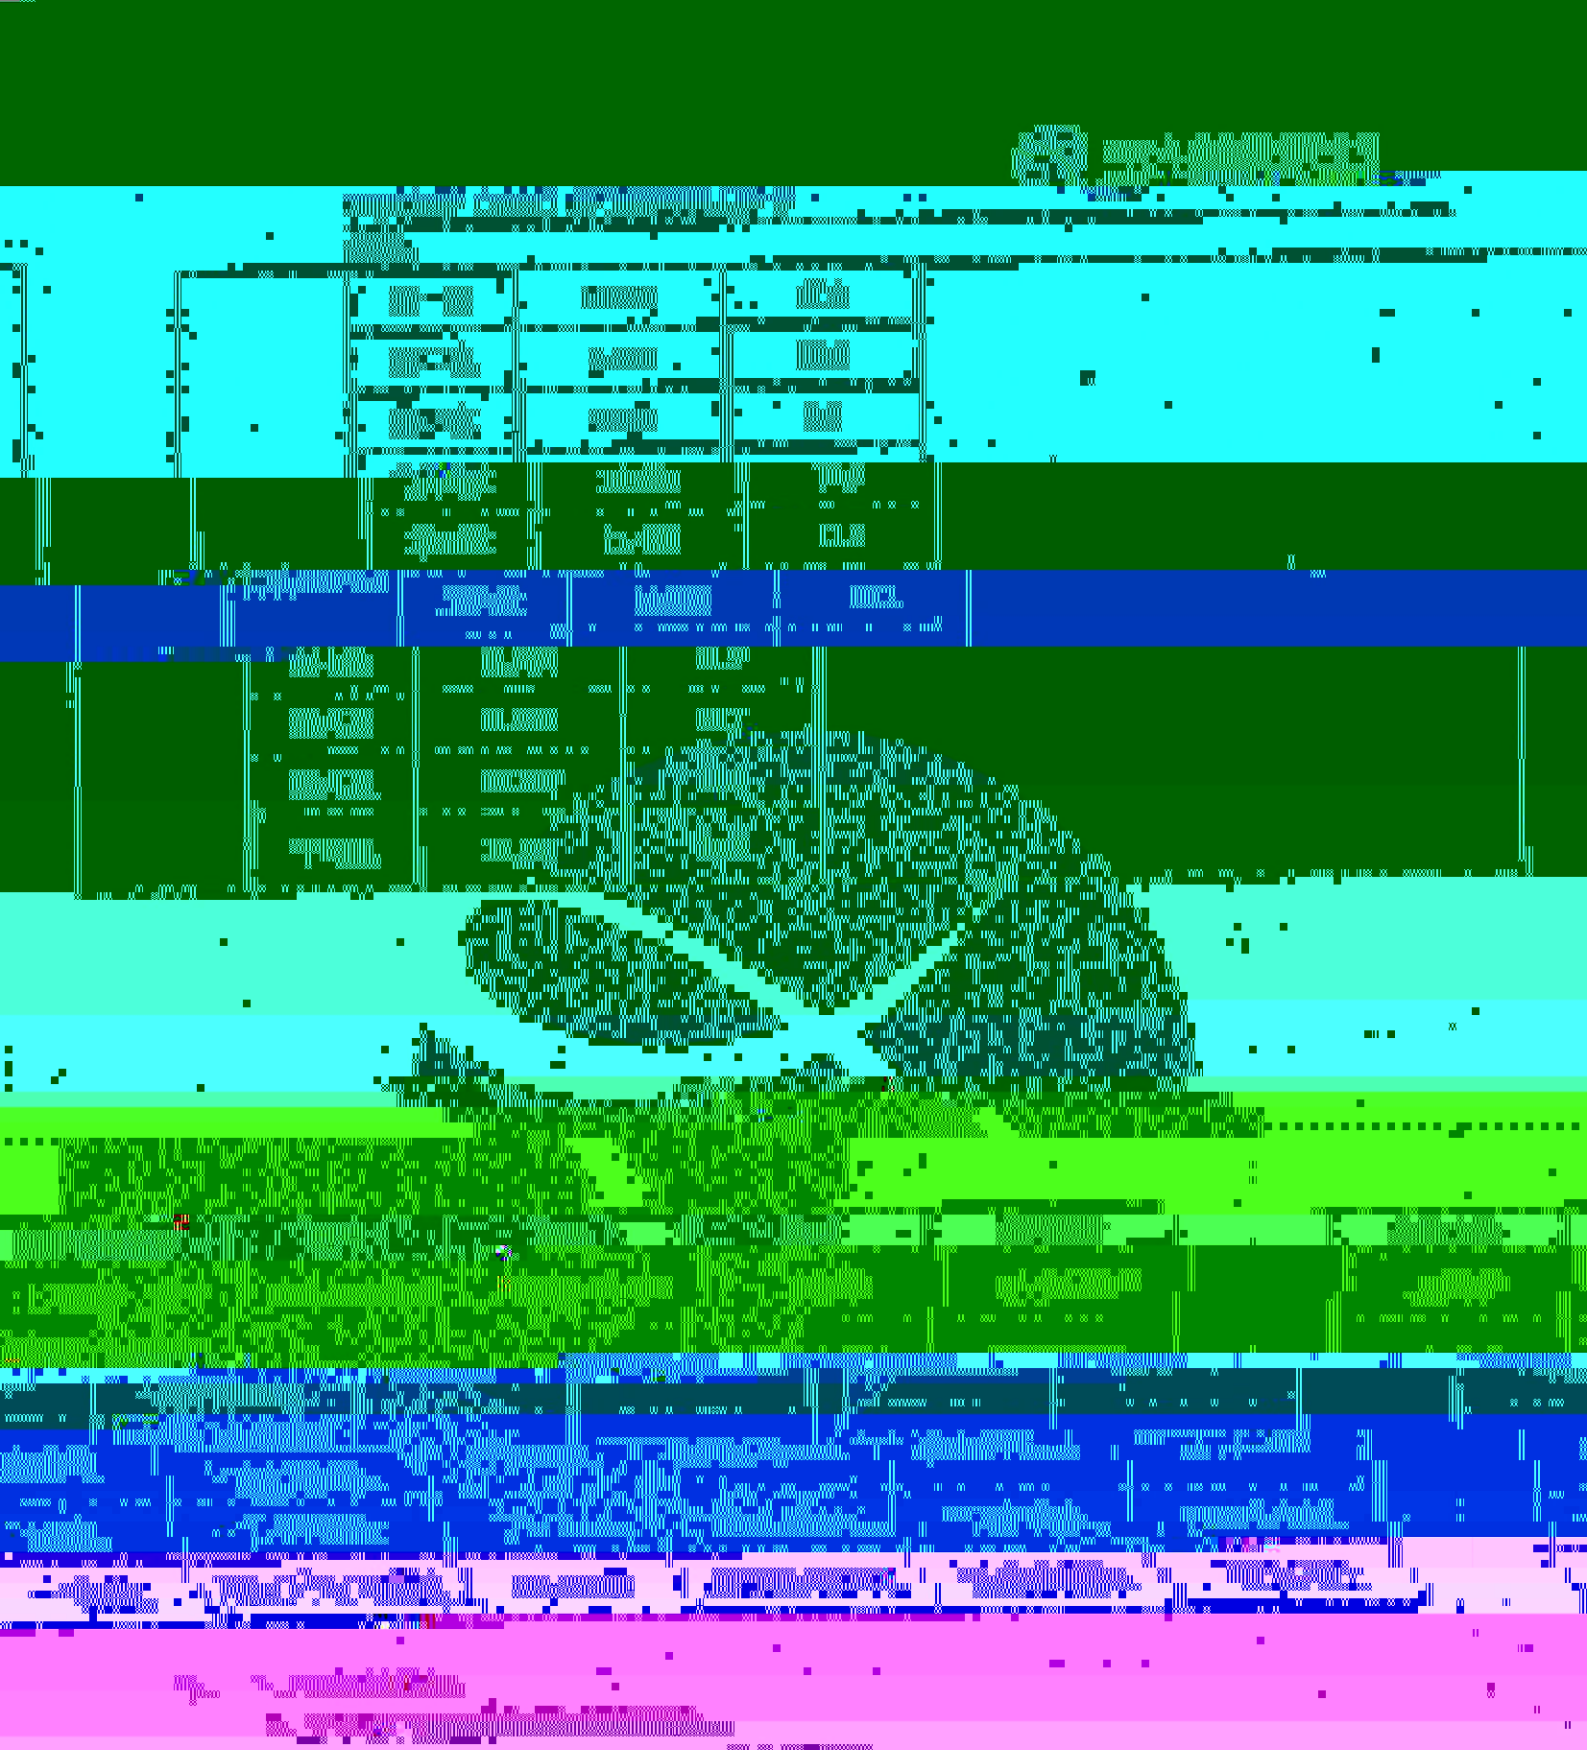

报告结束***