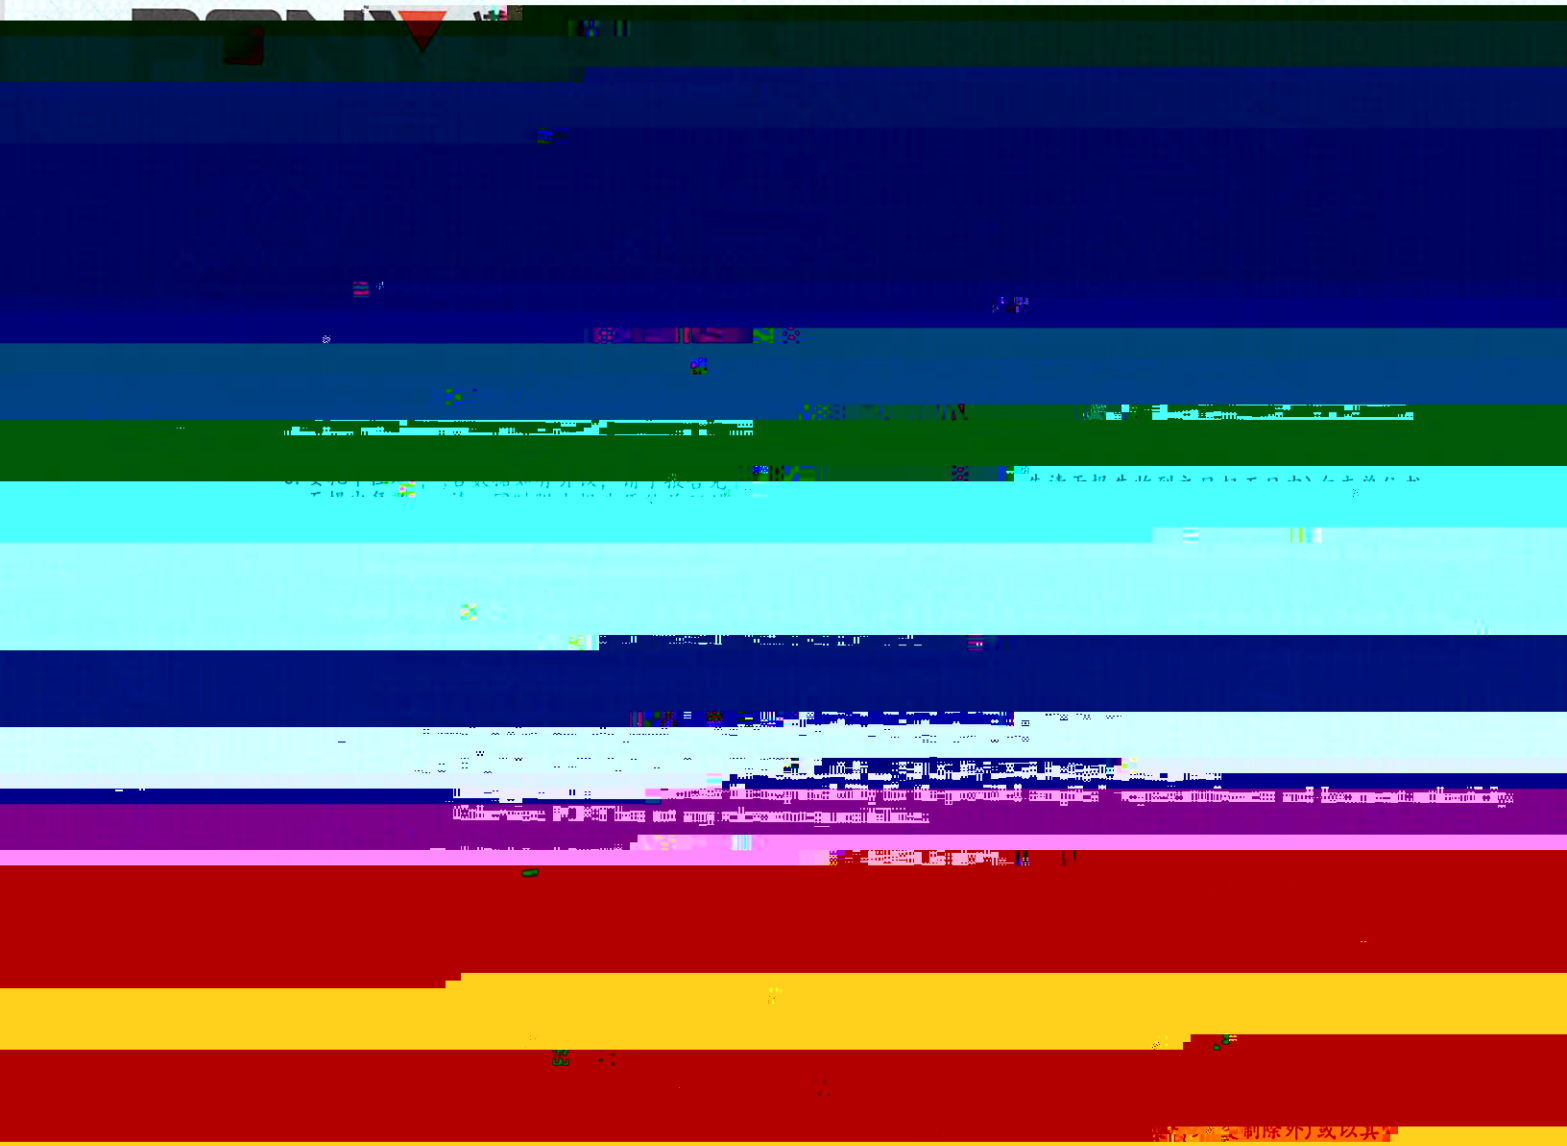
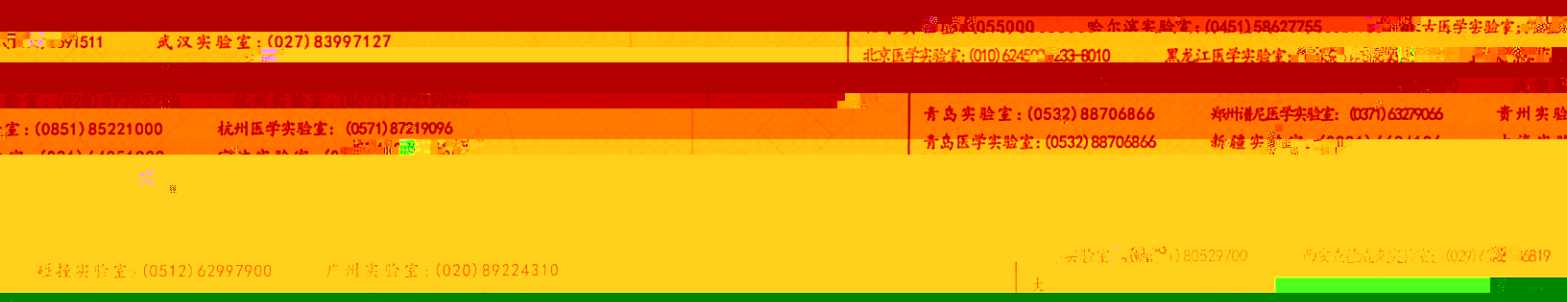

PONY
普元测试
Pony Testing International Group





ucing except in full,

without approval of PONY. PONY shall investigate and affix the applicant's legal liability accordingly



武汉实验室：(027) 83997127

北京医学实验室：(010) 624[illegible]33-8010 黑龙江医学实验室

杭州医学实验室：(0571) 87219096

青岛实验室：(0532) 88706866 郑州湘尼医学实验室：(0371) 63279066

青岛医学实验室：(0532) 88706866

广州实验室：(020) 89224310

检测结果(Test Results)：

检测报告
(Test Report)

(Attached table 1: List of method)

离子体发射光谱法 HJ 781-2016	光谱仪	0.01 mg/L	
固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等	电感耦合等离	0.004 mg/L	
液法 HJ/T 300-2007 7.1 含水率测定		0.1%	

本页以下空白
(The page below is blank)

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group

检 测 报 告
(Test Report)

(Instrument and Equipment)	(Instrument Model)	(Instrument Number)
电子天平	ML204	B24E220425
紫外可见分光光度计	UV-1800	[illegible]001-05

公司地址：上海市松江区[illegible]号1幢4层A区
检测地址：上海市松江区福园路288号
电话：021-64851999