



中国疾病预防控制中心

疾病预防控制中心

疾病预防控制中心




疾病预防控制中心

疾病预防控制中心

疾病预防控制中心

疾病预防控制中心

疾病预防控制中心

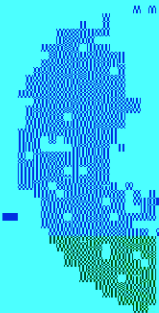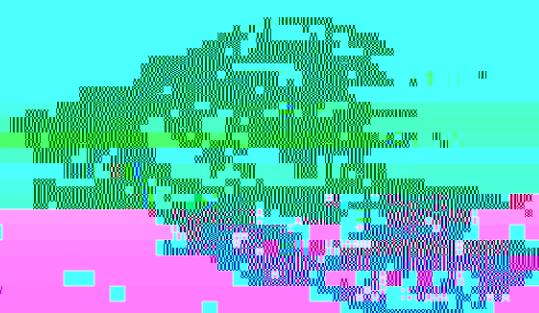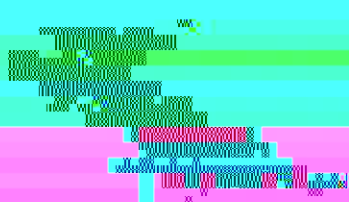

1. 本报告无检验检测专用章、报告骑缝章和批准人签章无效。

This report is invalid without special seal of inspection, cross page seal and the signature of the approver.



谱尼测试
Pony Testing International Group

检测报告

(Test Report)

No. B2BB23027001

第1页, 共1页

收到日期 (Received Date)	2021-11-24	检测类别 (Test Type)	委托检测	(R)
检测日期 (Test Date)	2021-11-24~2021-11-30	检测环境 (Test Environment)	符合要求	(C)
检测项目 (Test Items)	见下页	样品状态 (Sample Status)	褐色固体	检 (Te
样品来源 (Sample Source)	送样	检测方法 (Test Methods)	见附表	(S
用主要仪器 (In Instruments)	见附表			所 (Ma
检测结论	该样品经检测, 所检项目符合GB 16330-2000 标准			
编辑人 (Edited by)	王吉	审核人 (Checked by)	陈建德	
批准人 (Approved by)	张利军	签发日期 (Issued Date)	2021年12月06日	(CA

(Test Report)

第 3 页, 共 4 页 (page 3 of 4)

镉	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪	0.01 mg/L
钡	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪	0.06 mg/L
镍	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪	0.02 mg/L

含水率	11.1/1300-2007个	电子分析天平	0.1g
含水率测定			

附表 2 仪器设备信息一览表

(Attached table 2: List of instrument and equipment information)

序号	设备名称	规格/型号	品牌	数量	使用状态	检定/校准日期	有效期至	存放地点	备注
1	气相色谱仪	GC-2060	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
2	液相色谱仪	LC-1260	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
3	原子吸收光谱仪	AAS-2000	岛津	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
4	电感耦合等离子体发射光谱仪	ICP-OES-2000	岛津	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
5	紫外-可见分光光度计	UV-2602	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
6	红外分光光度计	IR-2602	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
7	热重分析仪	TGA-2050	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
8	差示扫描量热仪	DSC-2050	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
9	扫描电镜	SEM-3000	日立	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
10	透射电镜	TEM-3000	日立	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
11	傅里叶变换红外光谱仪	FTIR-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
12	凝胶渗透色谱仪	GPC-2060	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
13	离子色谱仪	IC-2060	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
14	气态重金属分析仪	HR-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
15	微波消解仪	MA-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
16	原子荧光光谱仪	AAS-2000	岛津	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
17	电感耦合等离子体质谱仪	ICP-MS-2000	岛津	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
18	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
19	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
20	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
21	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
22	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
23	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
24	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
25	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
26	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
27	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
28	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
29	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
30	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
31	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
32	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
33	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
34	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
35	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
36	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
37	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
38	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
39	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
40	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
41	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
42	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
43	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
44	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
45	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
46	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
47	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
48	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
49	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
50	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
51	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
52	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
53	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
54	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
55	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
56	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
57	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
58	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
59	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
60	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
61	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
62	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
63	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
64	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
65	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
66	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
67	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
68	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
69	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
70	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
71	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
72	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
73	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
74	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
75	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
76	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
77	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
78	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
79	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
80	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
81	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
82	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
83	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
84	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
85	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
86	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
87	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
88	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
89	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
90	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
91	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
92	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
93	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
94	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
95	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
96	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
97	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
98	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
99	沉降粒度仪	SG-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	
100	激光粒度仪	LS-2000	安捷伦	1	在用	2023.05.15	2024.05.15	实验室	