

固定污染源烟气排放连续监测

系统比对监测报告

西昌市



报告编写: 贾彬彬


审 核: 王 楠

附件 1: 自动监测设备信息一览表

[illegible]

年	月	日	时	分	秒	毫秒	微秒	纳秒	皮秒	飞秒	阿秒	zepto	yocto
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

沈阳和平新城
 沈阳皇姑岭
 沈阳皇姑岭
 沈阳皇姑岭

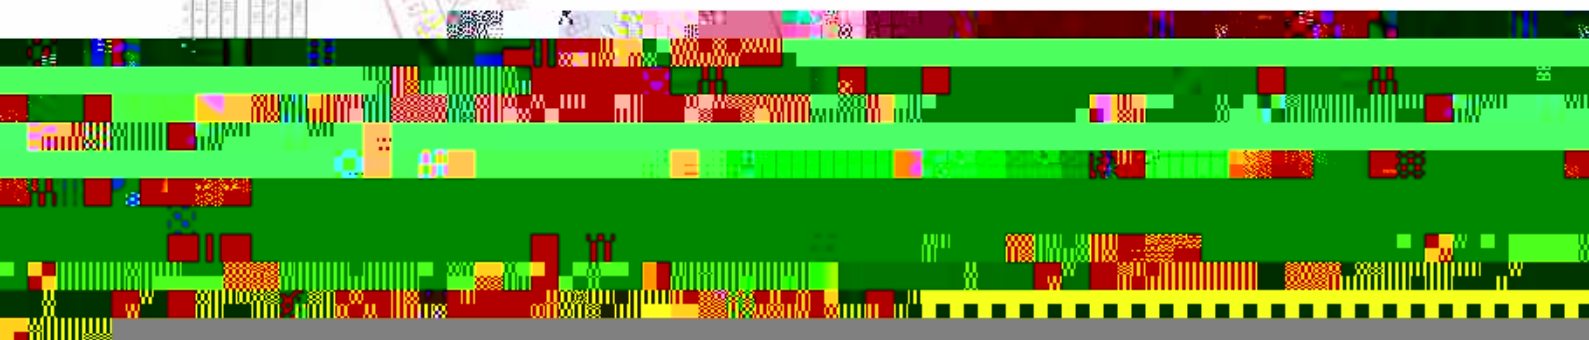

氧气 CMS/气态运

氧气 CEMS/气态污染物 CEMS 比对数据报表

孙超

邱敬坤

氧气 CMS/气态污染物 CEMS 比对数据报表

检测项目: Cc

测试人员:

杨静

邱紫婉

测试地点: 山东临沂新能源电力有限公司

测试点位: 焚烧炉尾气排放口

参比方法仪器生产厂家: 青岛卓立

型号、编号: 3026 / 027

测试日期: 2025



氧气 CEMS/气态污染物 CEMS 比对数据报告

检测项目: NO_x 检测人员: 王少华 王果皓

测试地点: 沁水县种新能有限公司 测试点位: 2#炉窑废气排放口


参比方法仪器生产厂家: 青岛崂友 型号、编号: SL211, 037

测试日期: 2023年4月12日 原理: 硝酸银容量法

样品编号	时间(时、分)	参比方法(RM) A	CEMS 法 B	数据对差率
1	8:00	1.00	1.00	0.00
2	8:05	1.00	1.00	0.00
3	8:10	1.00	1.00	0.00
4	8:15	1.00	1.00	0.00
5	8:20	1.00	1.00	0.00
6	8:25	1.00	1.00	0.00
7	8:30	1.00	1.00	0.00
8	8:35	1.00	1.00	0.00
9	8:40	1.00	1.00	0.00
10	8:45	1.00	1.00	0.00
11	8:50	1.00	1.00	0.00
12	8:55	1.00	1.00	0.00
13	9:00	1.00	1.00	0.00
14	9:05	1.00	1.00	0.00
15	9:10	1.00	1.00	0.00
16	9:15	1.00	1.00	0.00
17	9:20	1.00	1.00	0.00
18	9:25	1.00	1.00	0.00
19	9:30	1.00	1.00	0.00
20	9:35	1.00	1.00	0.00
21	9:40	1.00	1.00	0.00
22	9:45	1.00	1.00	0.00
23	9:50	1.00	1.00	0.00
24	9:55	1.00	1.00	0.00
25	10:00	1.00	1.00	0.00
26	10:05	1.00	1.00	0.00
27	10:10	1.00	1.00	0.00
28	10:15	1.00	1.00	0.00
29	10:20	1.00	1.00	0.00
30	10:25	1.00	1.00	0.00
31	10:30	1.00	1.00	0.00
32	10:35	1.00	1.00	0.00
33	10:40	1.00	1.00	0.00
34	10:45	1.00	1.00	0.00
35	10:50	1.00	1.00	0.00
36	10:55	1.00	1.00	0.00
37	11:00	1.00	1.00	0.00
38	11:05	1.00	1.00	0.00
39	11:10	1.00	1.00	0.00
40	11:15	1.00	1.00	0.00
41	11:20	1.00	1.00	0.00
42	11:25	1.00	1.00	0.00
43	11:30	1.00	1.00	0.00
44	11:35	1.00	1.00	0.00
45	11:40	1.00	1.00	0.00
46	11:45	1.00	1.00	0.00
47	11:50	1.00	1.00	0.00
48	11:55	1.00	1.00	0.00
49	12:00	1.00	1.00	0.00
50	12:05	1.00	1.00	0.00
51	12:10	1.00	1.00	0.00
52	12:15	1.00	1.00	0.00
53	12:20	1.00	1.00	0.00
54	12:25	1.00	1.00	0.00
55	12:30	1.00	1.00	0.00
56	12:35	1.00	1.00	0.00
57	12:40	1.00	1.00	0.00
58	12:45	1.00	1.00	0.00
59	12:50	1.00	1.00	0.00
60	12:55	1.00	1.00	0.00
61	13:00	1.00	1.00	0.00
62	13:05	1.00	1.00	0.00
63	13:10	1.00	1.00	0.00
64	13:15	1.00	1.00	0.00
65	13:20	1.00	1.00	0.00
66	13:25	1.00	1.00	0.00
67	13:30	1.00	1.00	0.00
68	13:35	1.00	1.00	0.00
69	13:40	1.00	1.00	0.00
70	13:45	1.00	1.00	0.00
71	13:50	1.00	1.00	0.00
72	13:55	1.00	1.00	0.00
73	14:00	1.00	1.00	0.00
74	14:05	1.00	1.00	0.00
75	14:10	1.00	1.00	0.00
76	14:15	1.00	1.00	0.00
77	14:20	1.00	1.00	0.00
78	14:25	1.00	1.00	0.00
79	14:30	1.00	1.00	0.00
80	14:35	1.00	1.00	0.00
81	14:40	1.00	1.00	0.00
82	14:45	1.00	1.00	0.00
83	14:50	1.00	1.00	0.00
84	14:55	1.00	1.00	0.00
85	15:00	1.00	1.00	0.00
86	15:05	1.00	1.00	0.00
87	15:10	1.00	1.00	0.00
88	15:15	1.00	1.00	0.00
89	15:20	1.00	1.00	0.00
90	15:25	1.00	1.00	0.00
91	15:30	1.00	1.00	0.00
92	15:35	1.00	1.00	0.00
93	15:40	1.00	1.00	0.00
94	15:45	1.00	1.00	0.00
95	15:50	1.00	1.00	0.00
96	15:55	1.00	1.00	0.00
97	16:00	1.00	1.00	0.00
98	16:05	1.00	1.00	0.00
99	16:10	1.00	1.00	0.00
100	16:15	1.00	1.00	0.00



CMV-YTIV-BCH11-02/D/1

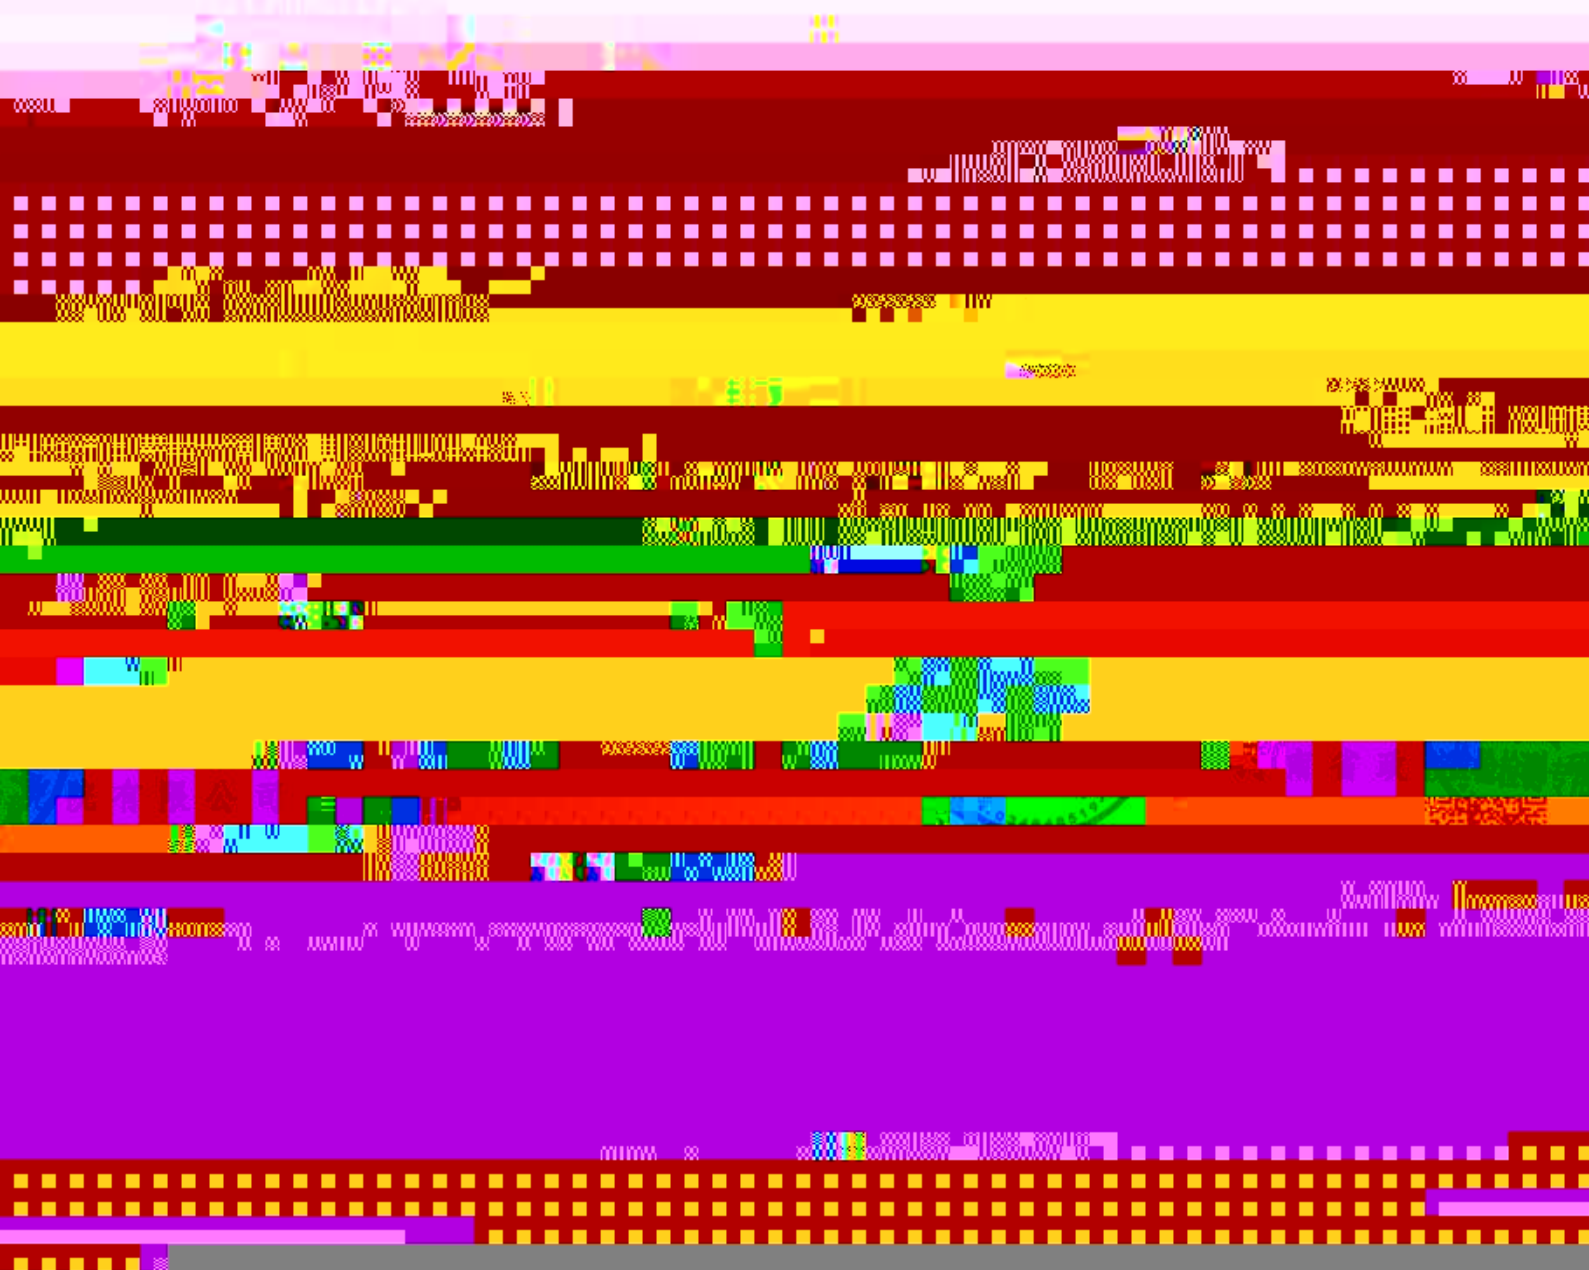



检 测 报 告

						续上表
检测点位	检测项目	采样日期	检测时段	检测结果	单位	排气筒高度 / m

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	采样日期	检测时段	检测结果	单位	排气筒高度 (m)
	氯化氢	2023.4.12	14:38-15:38	16.6	mg/m ³	
			15:54-16:54	14.6	mg/m ³	
			17:11-18:11	15.1	mg/m ³	