





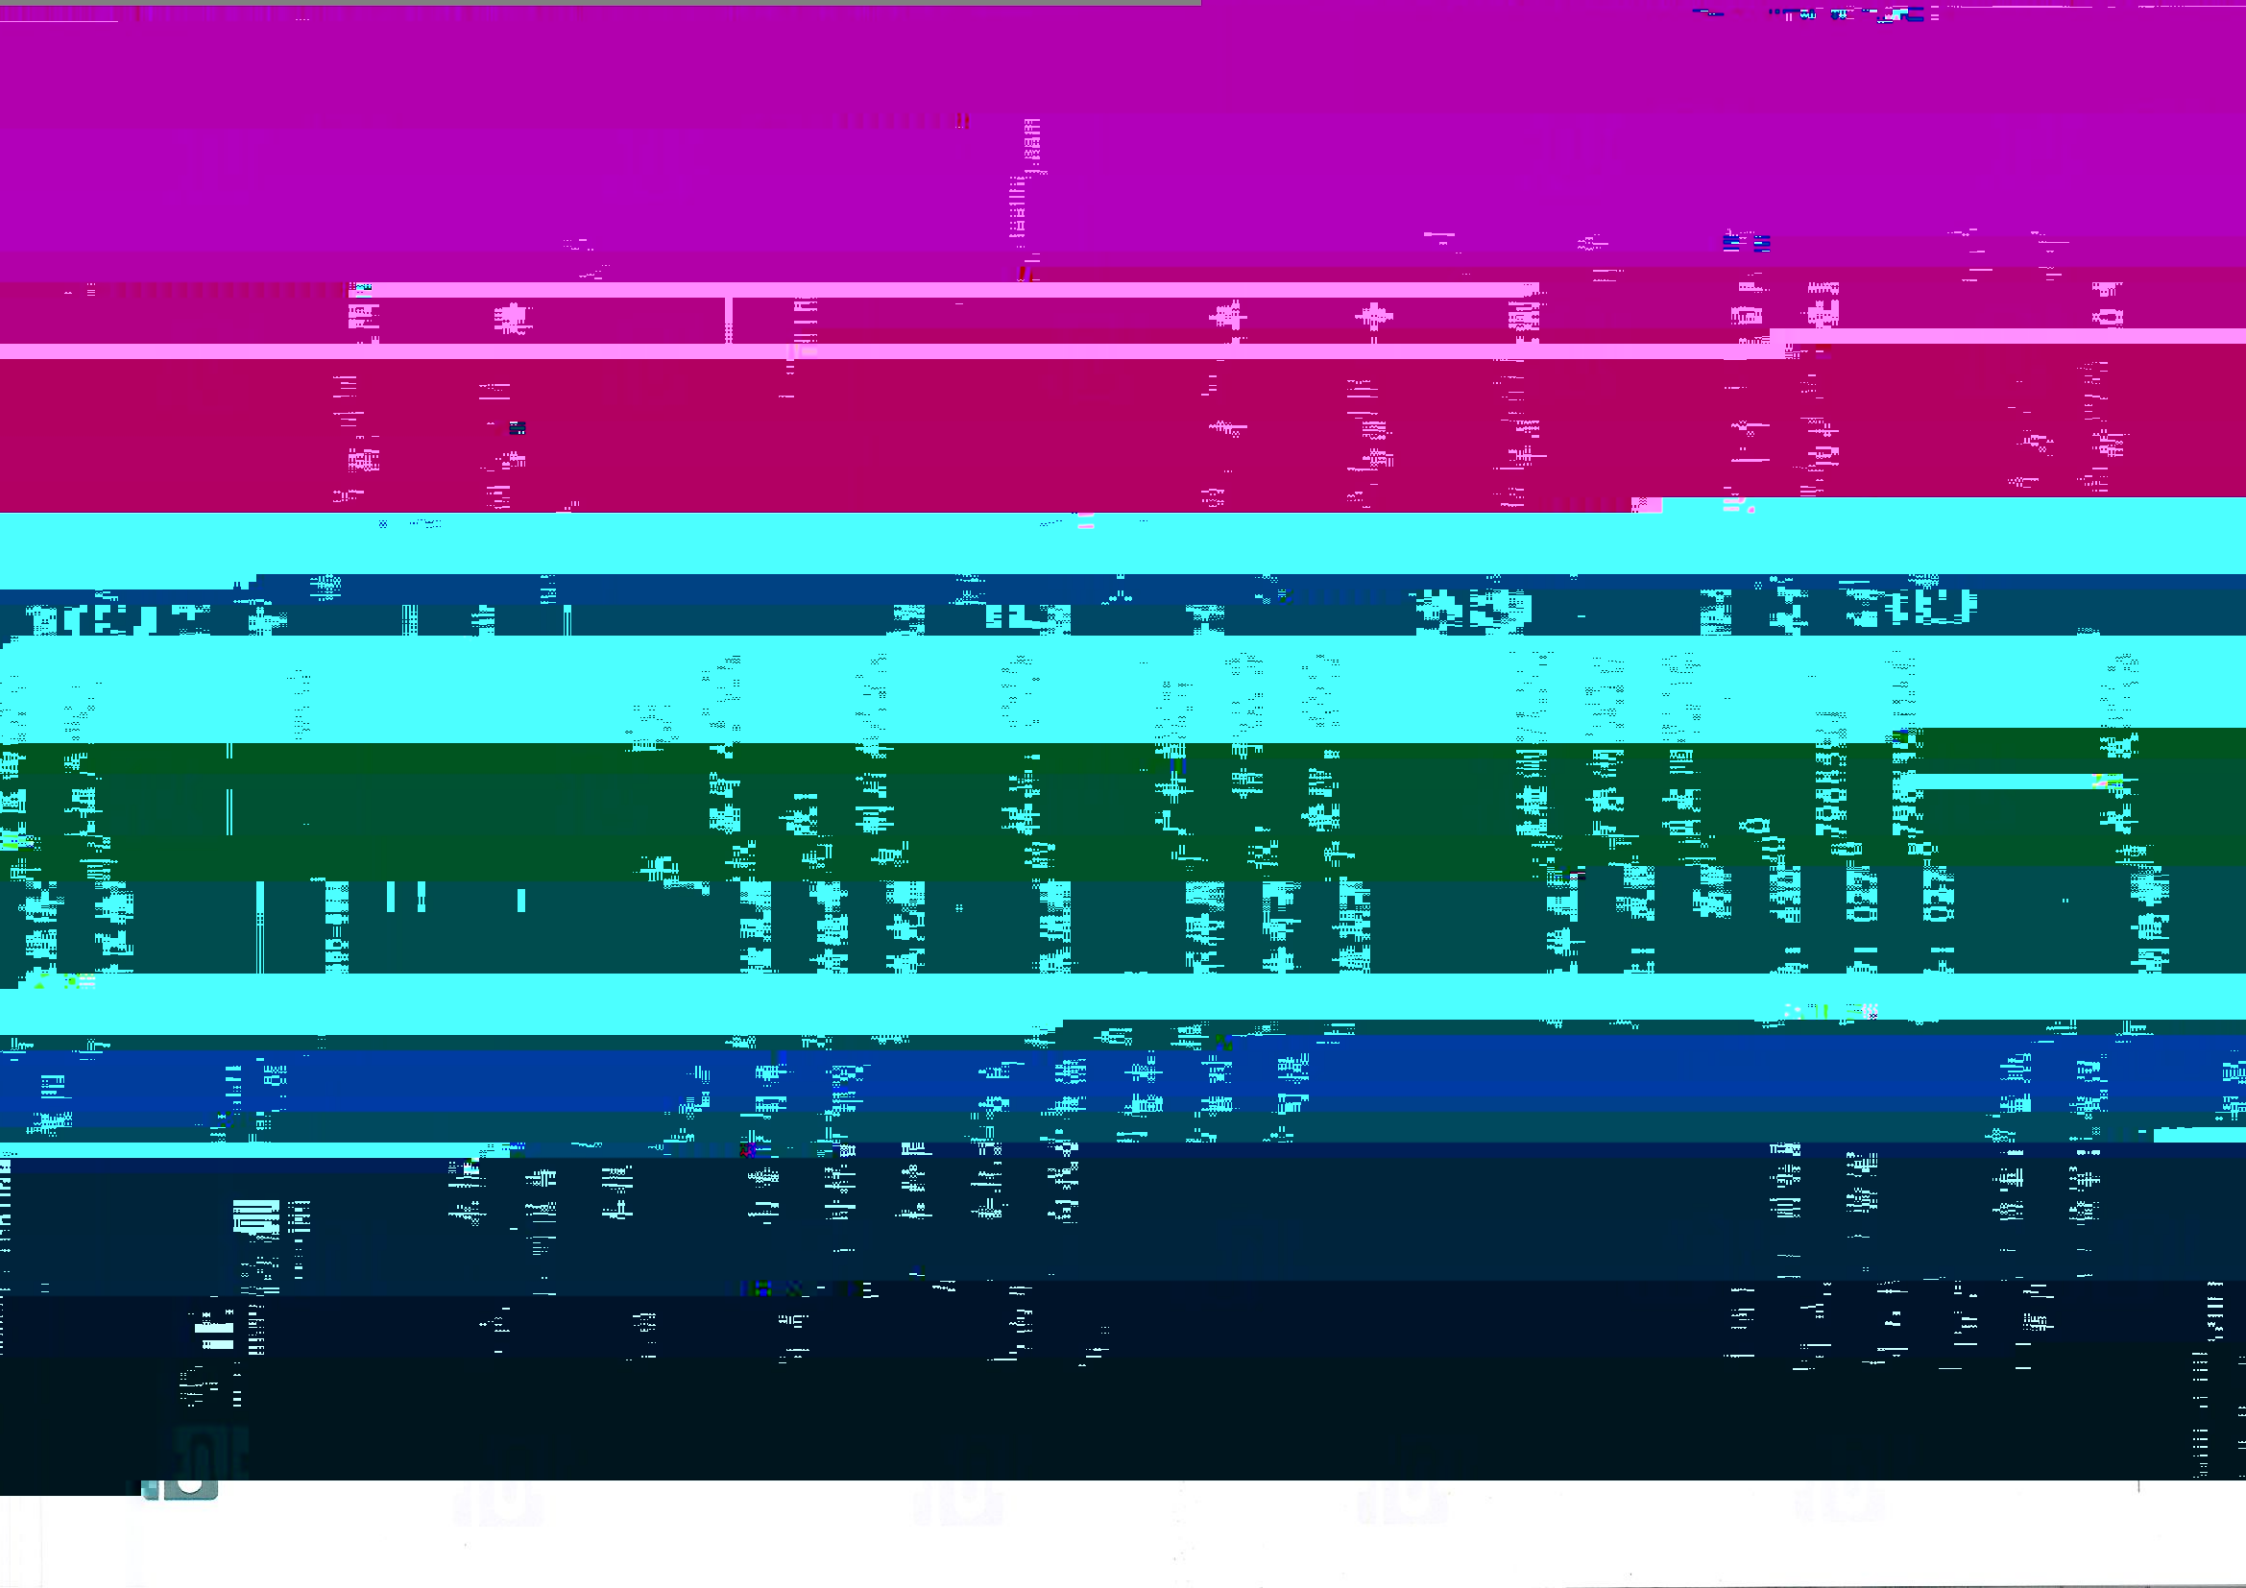

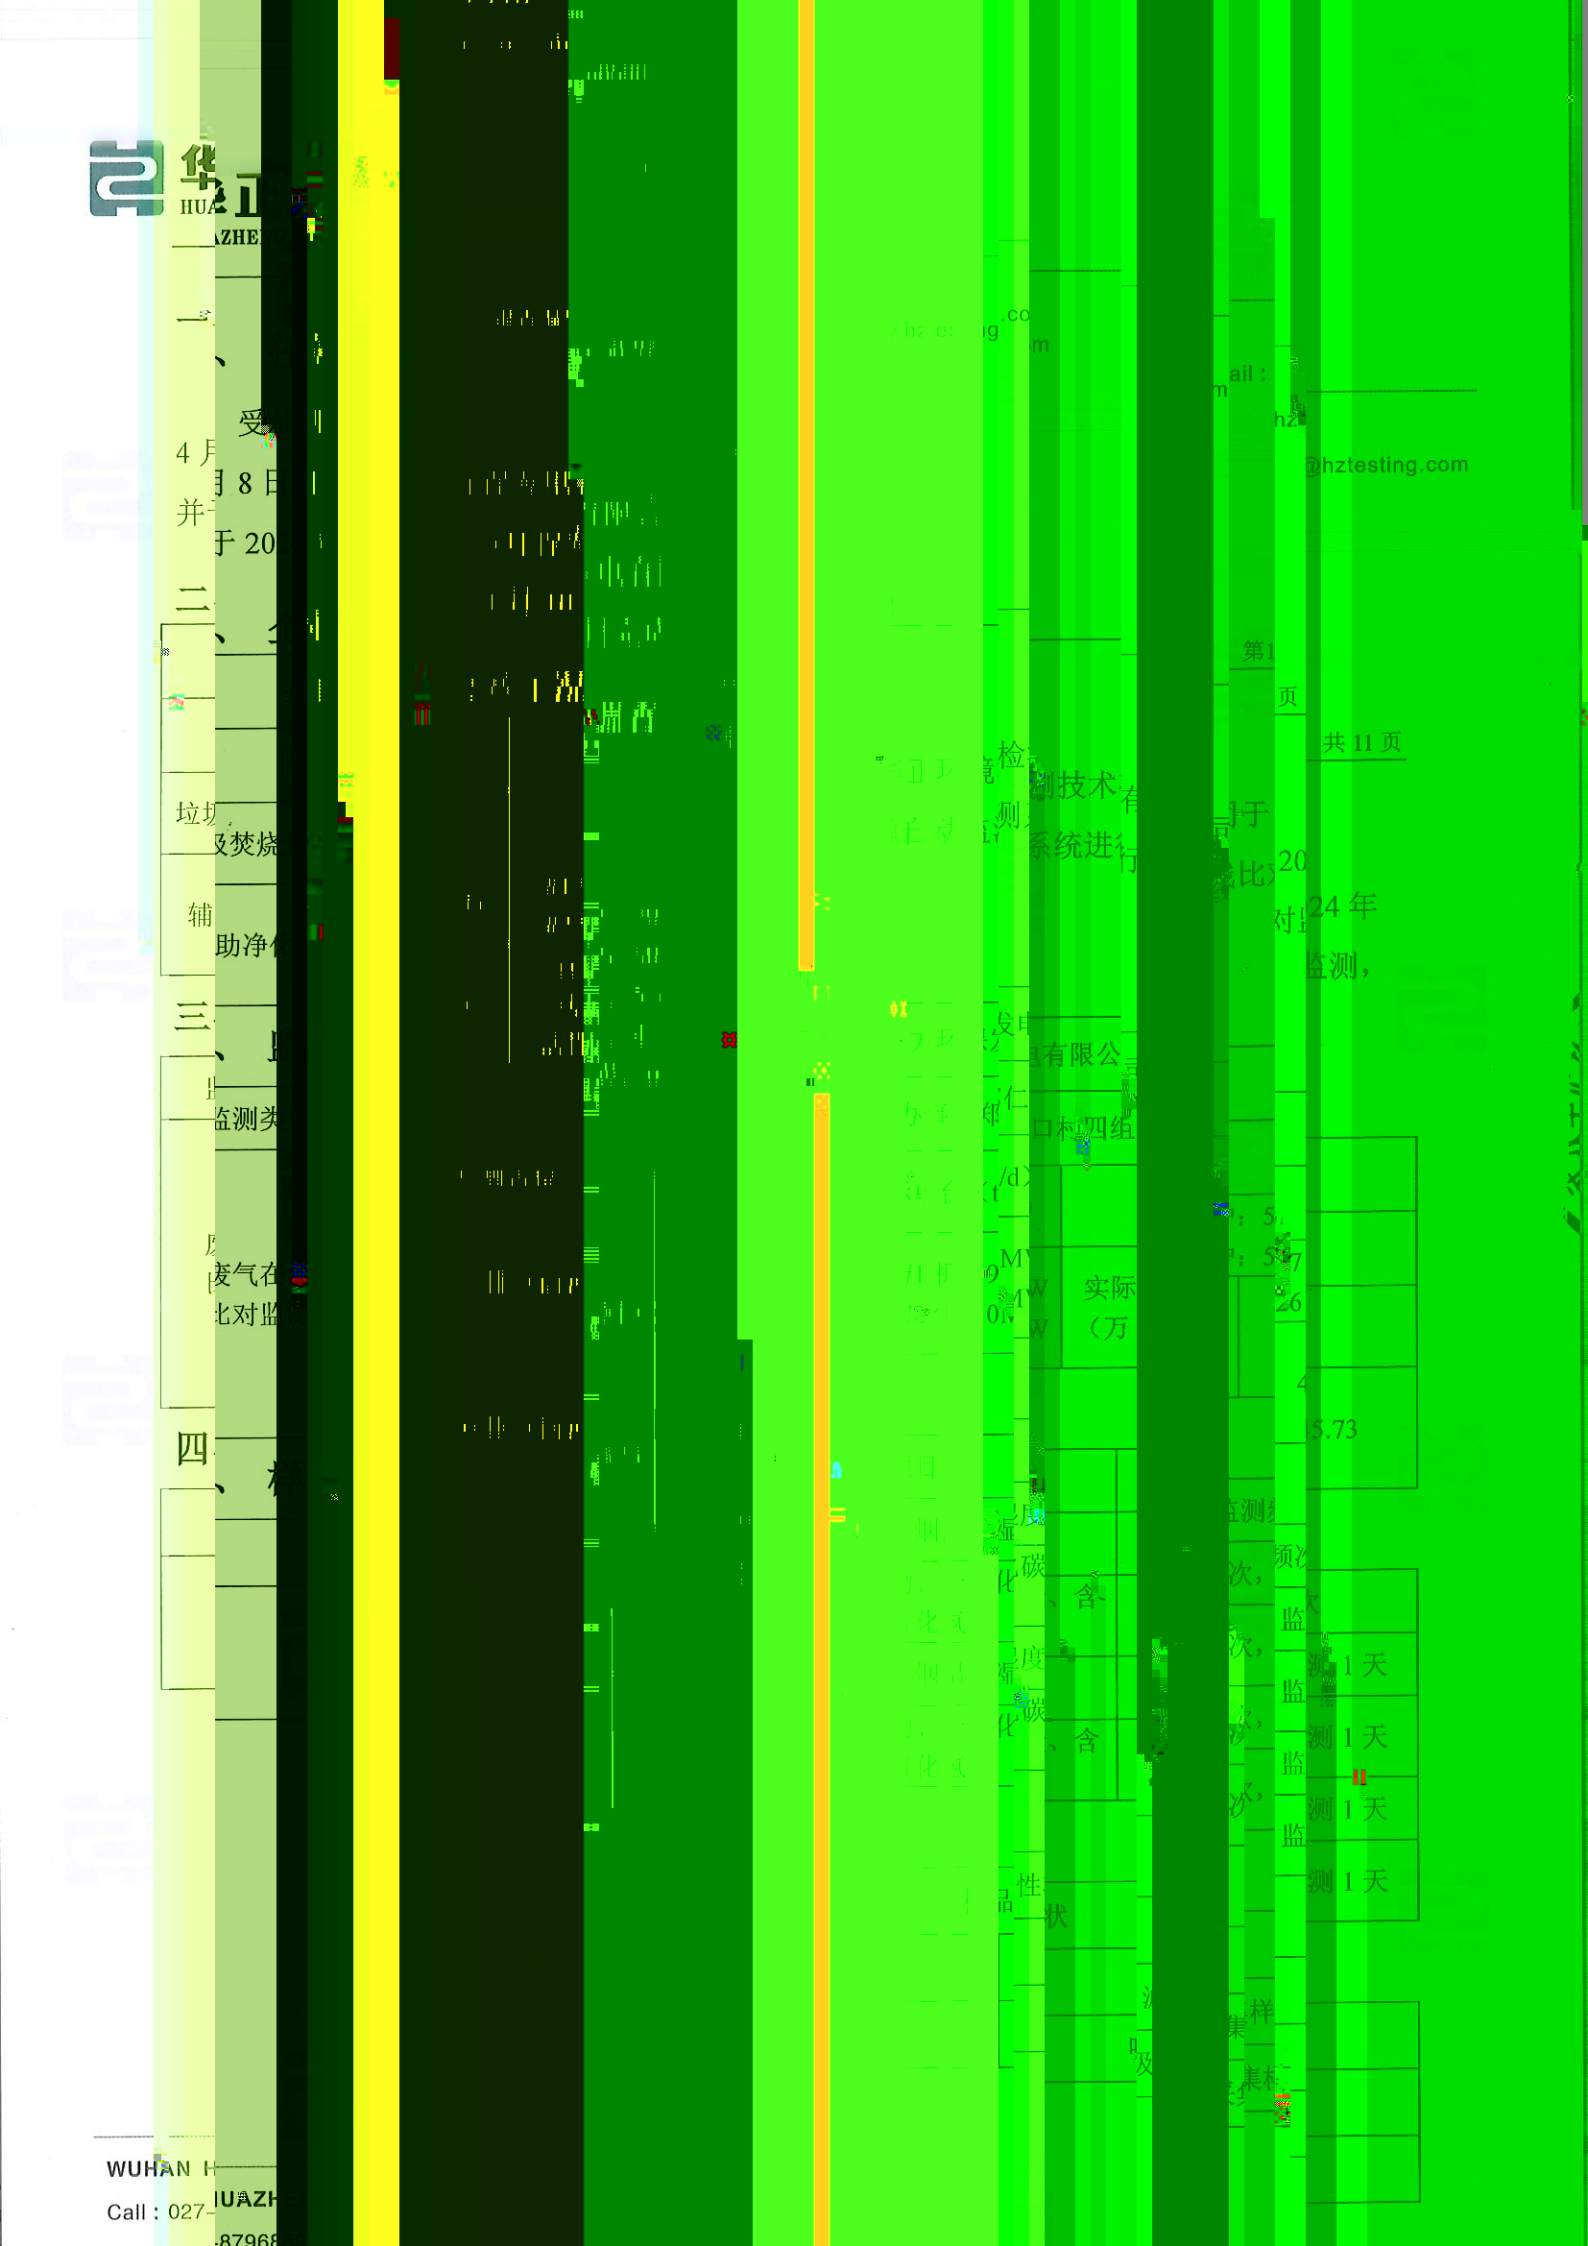

HUAZH
WUHAN H
Call：027-

报告编号：武


一氧化碳、氯化氢自动监测设

号）《关于加强生活垃圾焚发电厂

术要求见表 2：

表 2

检测项目			排放浓度均值
一氧化碳	准确度	≥250μmol/mol	≥250μmol/mol
		≥50μmol/mol	≥50μmol/mol
氯化氢	准确度	≥25mg/m³	≥25mg/m³
		≥20μmol/mol	≥20μmol/mol
		<20μmol/mol	<20μmol/mol
		排放浓度均值	排放浓度均值
		≥250μmol/mol	≥250μmol/mol
		≥50μmol/mol	≥50μmol/mol
		<50μmol/mol	<50μmol/mol

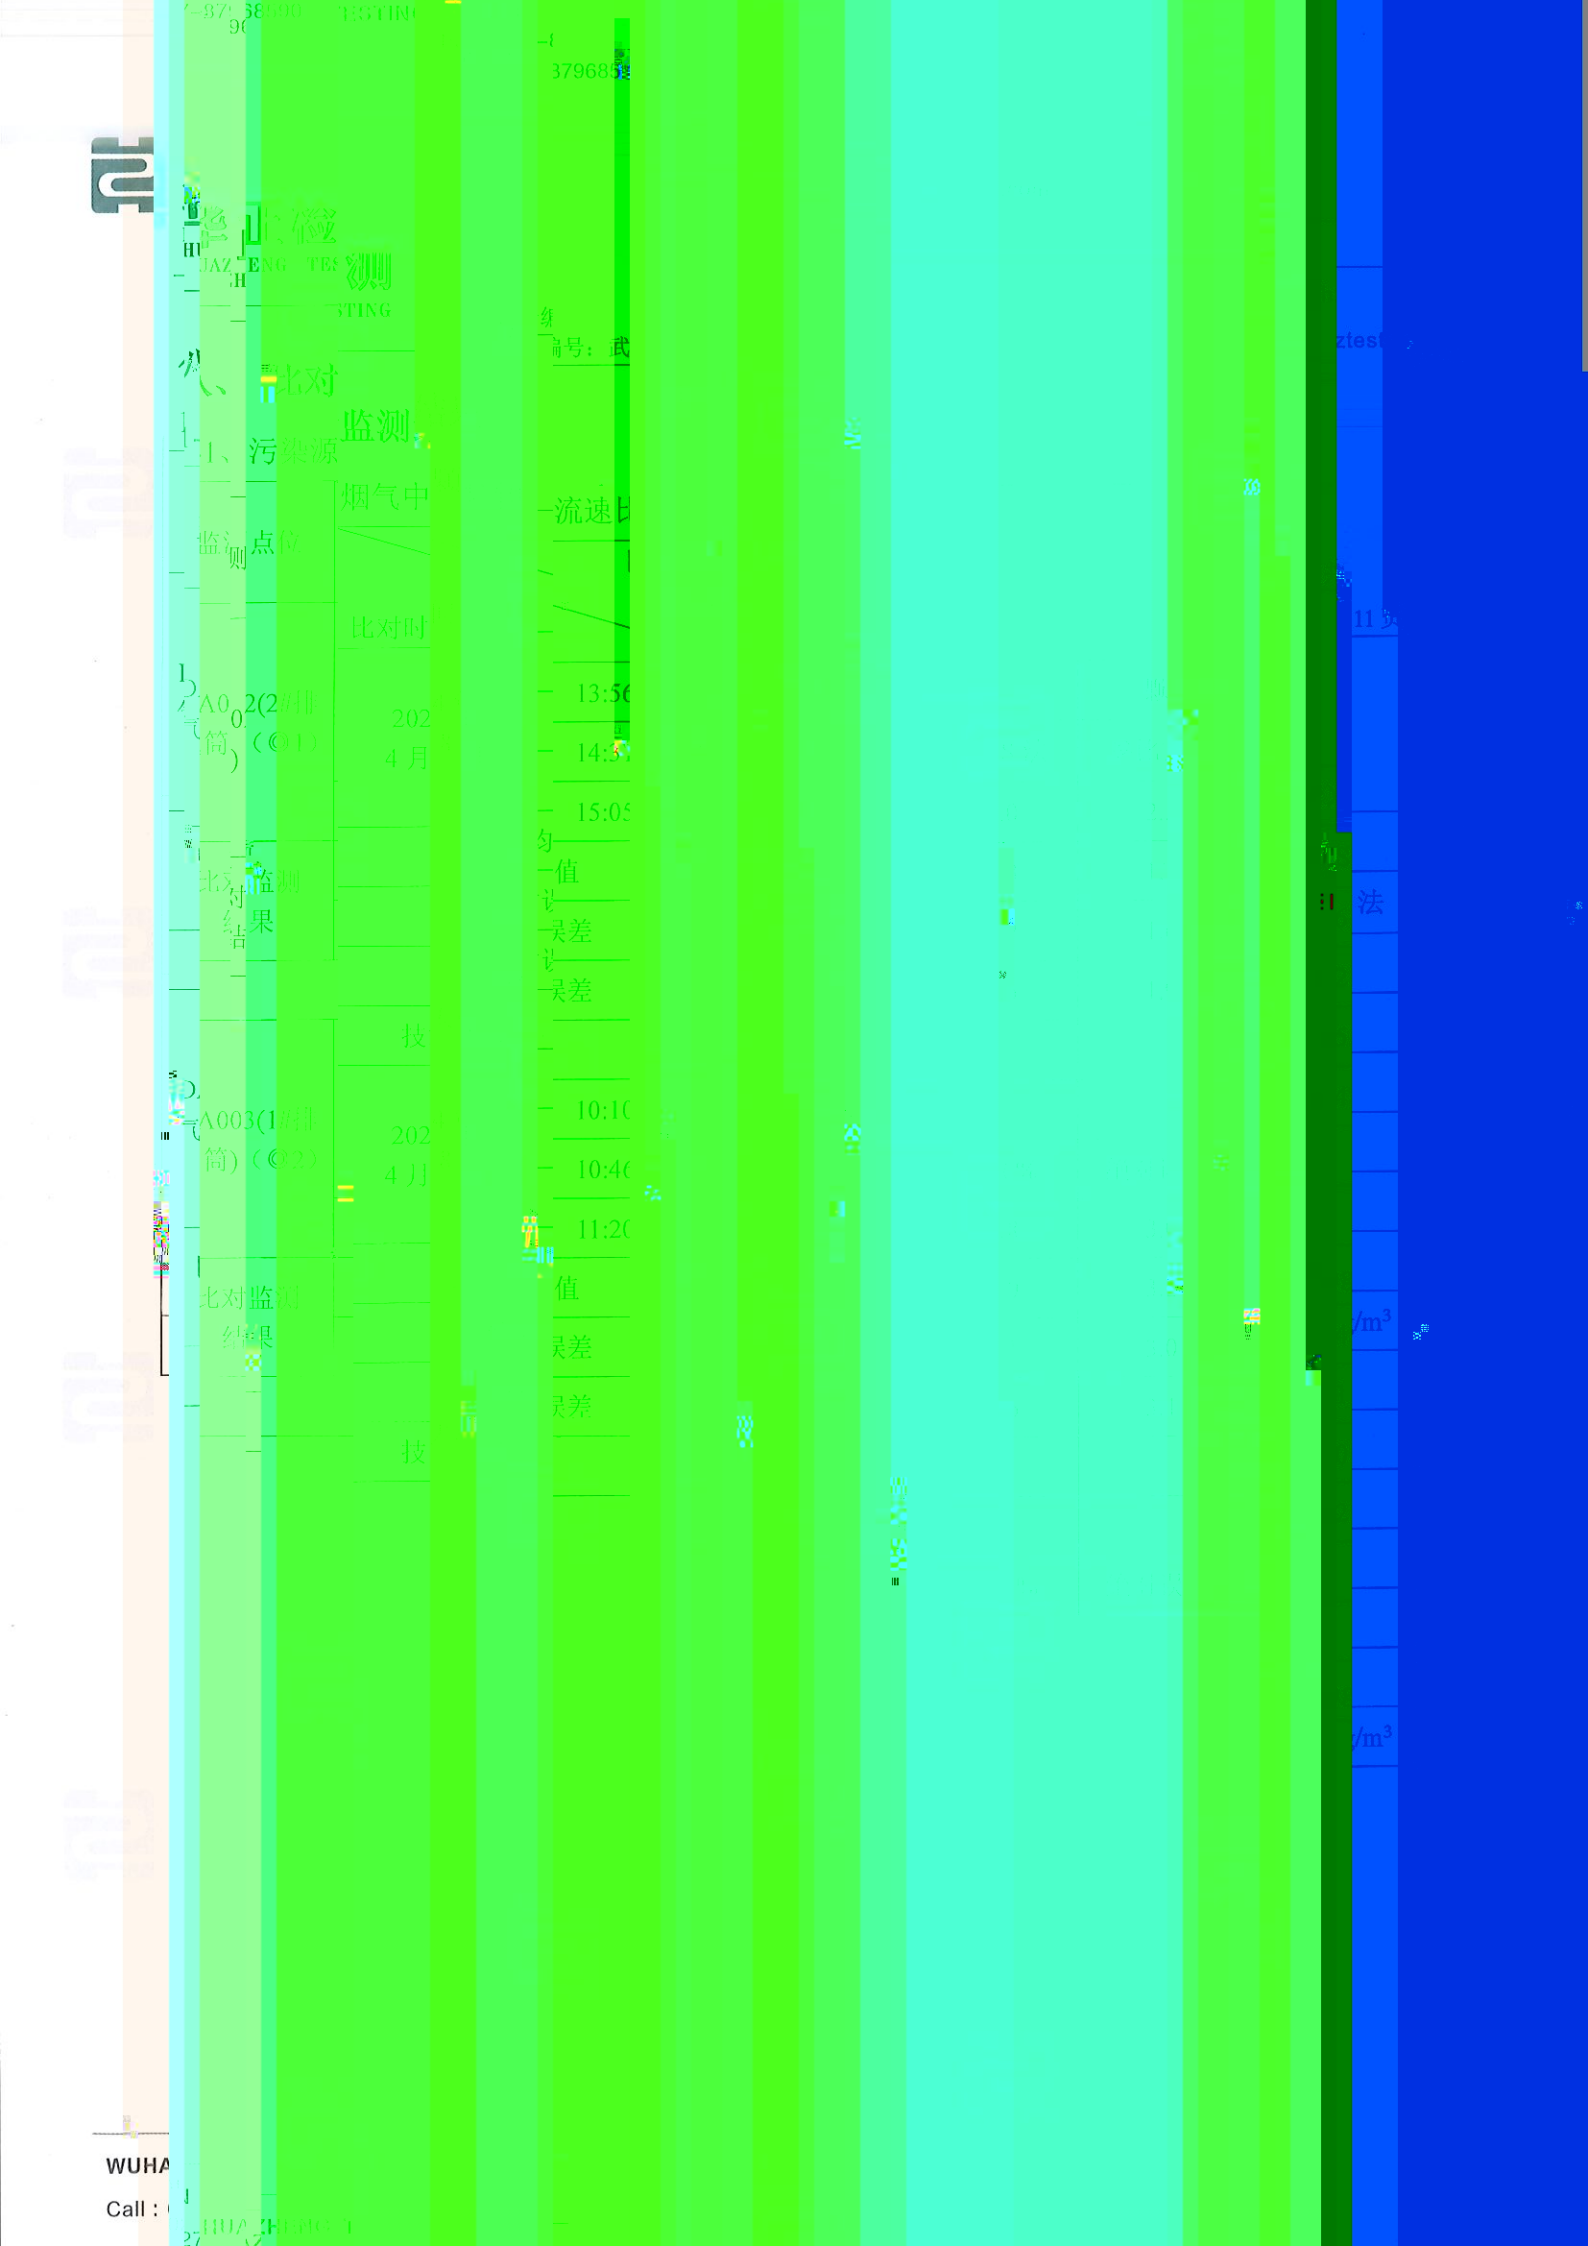

1-2、

监测	
DA002(气筒)(	
比对监 结果	
DA003(气筒)(	
比对监 结果	

2、

监	
DA 排 （◎	
比对 结	
DA0 排 （◎	
比	
备注	

NU AZHE NG
Cal HAN HU 90
l：027-8 79685

www.hztesting

华正
HUA ZHEN

检字2024（0335）号

4、污染源

监测点位	烟气	监测
	参比方法（mg/m³）A	
DA002(2#排筒)（◎1）	13	
	ND	
	ND	
	ND	
	ND	
	ND	
	3	
比对监测结		
	绝对误差≤6μmo	
样品类型	监测日期	
监测点位	参比方法（mg/m³）A	
	ND	
	7	
DA003(1#排筒)（◎2）	ND	
	ND	
	39	
	3	
	9	
比对监测结		
	绝对误差≤6μmo	
备注：ND 表	参与计算时以 1/2 检出限	

WUH IAN H
Call : 027 -UA
-87

比对监测结

监测结果表明：

次比对监测结果

编制人：

日 期：2024.4.25